

었다. 측정과정에서 다소 번잡하였으나 비교적 안정성이 있고 오래도록 사용할 수 있어 Q·C 용구로서 임상에서 이용하는데에는 적합하다고 사료하였다.

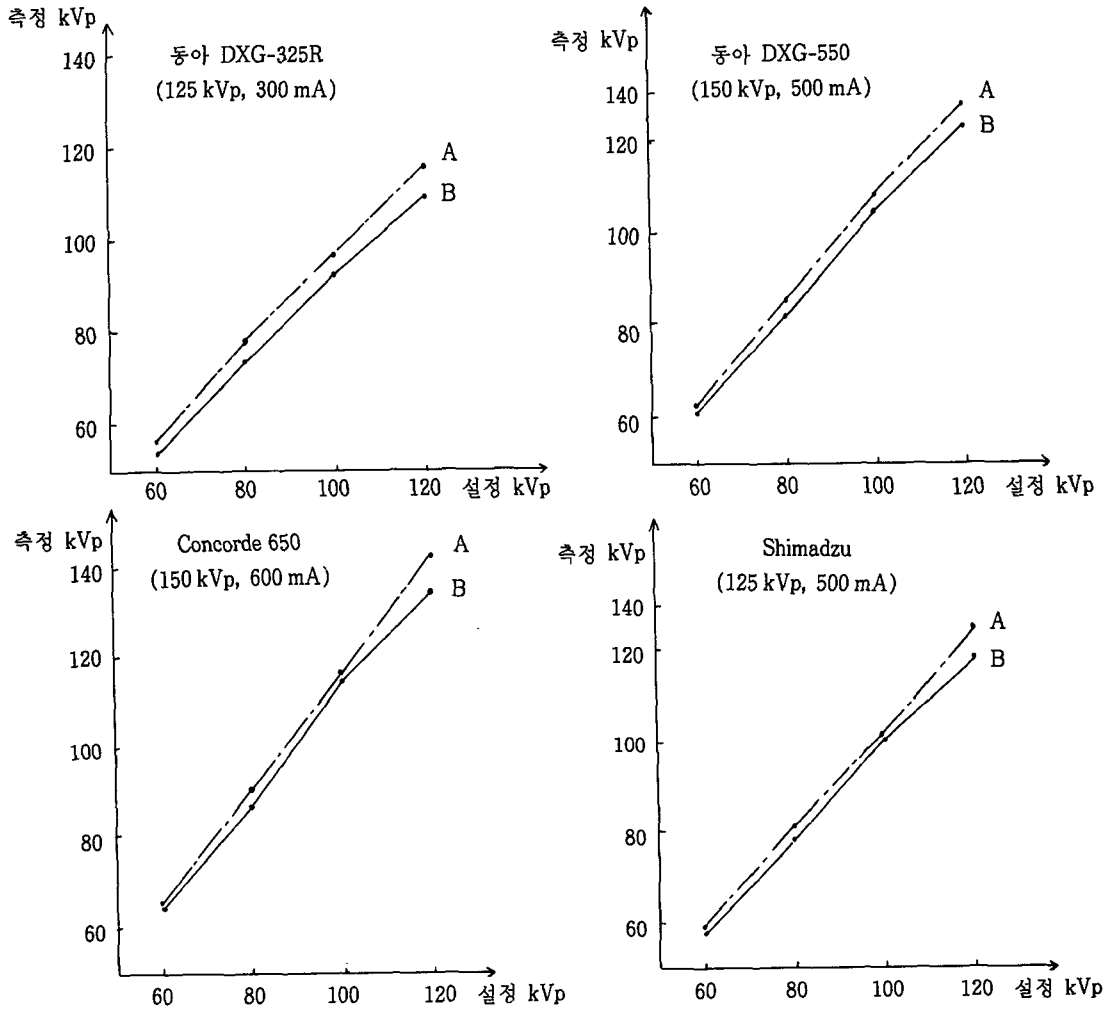


그림 측정결과

A : Ser 105A-2770, B : Ser 105A-1037

### <3> X선관의 실효초점 측정에 관한 고찰

서울대학교병원 진단방사선과

장광현 · 임오수 · 김형기 · 송창욱 · 정경모 · 정 환